Manchon Confiance
Formulaire de commande

POUR COMMANDER
Courriel : ca.elvarex@essity.com
Tél. : 1 877 978-5526 | 1 877 358-2739
Téléc. : 1 877 978-9703

Nom du patient/Code ID ou N° du dossier _____ DDN _____ Date _____

Genre M ☐ F ☐

Adresse _____

Ville/province/code postal _____

Diagnostic _____

N° du bon de commande

Commande initiale ☐ Renouvellement de commande avec changements ☐

Renouvellement de commande exacte ☐ _____ N° de schéma

Nom de l'ajusteur _____ N° de l'ajusteur _____ Tél. de l'ajusteur _____

Établissement de l'ajusteur _____ Courriel _____

Expédier au n° de compte _____ Nom du compte _____

Adresse _____ Ville _____ Province _____ Code postal _____

Courriel _____ Tél. _____ Téléc. _____

Facturer au n° de compte _____ Nom du compte _____

Adresse _____ Ville _____ Province _____ Code postal _____

Courriel _____ Tél. _____ Téléc. _____

N° de téléc. pour confirmation _____

Courriel _____

En choisissant de communiquer par courriel (ci-haut), je reconnais que les renseignements personnels sur la santé liés à cet achat pourraient être transmis par Essity sans être chiffrés.

Quantité/Classe	CLC1 (15-21 mmHg*)	CLC2 (23-32 mmHg*)
Gauche		
Droit		

Couleur
- ☐ Beige
- ☐ Noir
- ☐ Chiné rouge
- ☐ Caramel
- ☐ Chiné Jeans
- ☐ Chiné anthracite

Styles
- ☐ CG1
- ☐ AG1

Options pour le coude
- ☐ Zone confort au coude

Options de flexion pour le coude
- ☐ Coude 25 degrés (standard)
- ☐ Coude 45 degrés

Élévation latérale = 10 % de la circonférence à G et n'est pas ajustable (p. ex. si cG est 35 cm, l'élévation latérale sera 3,5 cm)

Options d'ornement
- ☐ Détail décoratif (devant du vêtement)
- ☐ Init. patient Max. 2 lettres (A à Z) _____

Bande de silicone
- ☐ Pas de silicone
- ☐ 2,5 cm SoftFit
- ☐ 2,5 cm au-dessus
- ☐ 2,5 cm intérieur 1/2

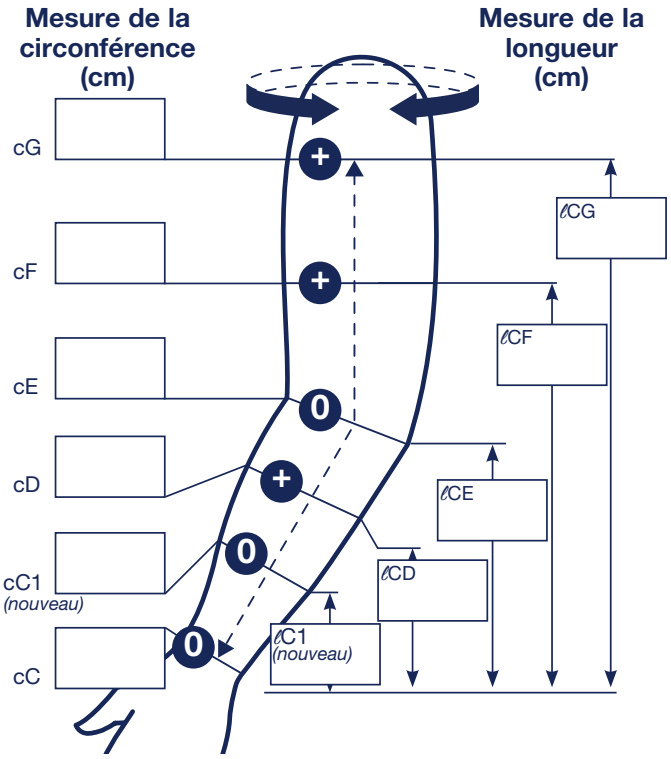

Directives pour la prise des mesures

(Ne s'appliquent qu'à la gamme Confiance)

Consulter le schéma du bras pour la tension applicable à chaque point de mesure.

Mesurer chaque circonférence à la main, aux doigts et au pouce, sans serrer. Consultez les Directives de mesure JOBST pour obtenir l'information pertinente détaillée.

0 sans tension

+ légère tension

cG = 0 sans tension avec bande de silicone

cG = + légère tension sans bande

ℓC1 = 5 à 7 cm au-dessus de cC

(ℓCG Mesure avec coude fléchi)

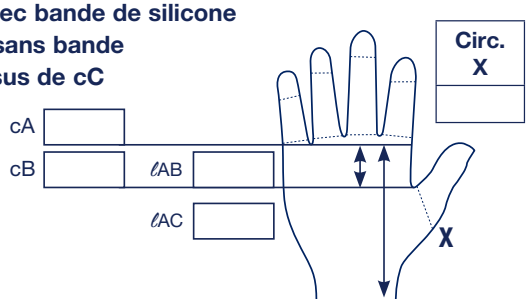

* Pression nominale

Pour obtenir des formulaires de commandes additionnels, visitez le site : http://www.jobstcompressioninstitute.com/resources/orders

essity

Essity, 1275 North Service Road West, bureau 800
Oakville, ON Canada L6M 3G4
Tél. 1 877 978-5526 Téléc. 1 877 978-9703

64039F R3 136164

© Essity, Produits de santé et d'hygiène, AB, 2023

C23